

# お詫びと訂正

「Clinical Engineering」2024年3月号（Vol.35 No.3）、197ページに記載の  
ニチバンメディカル株式会社のホームページのURLにおきまして、誤りがございました。  
読者の皆様に謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

誤：URL：<https://www.nichibanmedical.cp.jp>

正：URL：<https://www.nichibanmedical.co.jp>

2024年2月20日


Gakken メディカル出版事業部

# お詫びと訂正


「Clinical Engineering」2024年3月号 (Vol.35 No.3), 268 ページ 第44回午後第13問の解説におきまして、誤りがございました。読者の皆様に謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

正) 問題と解説の回路図において、電流の向きが逆になっていました。

問題

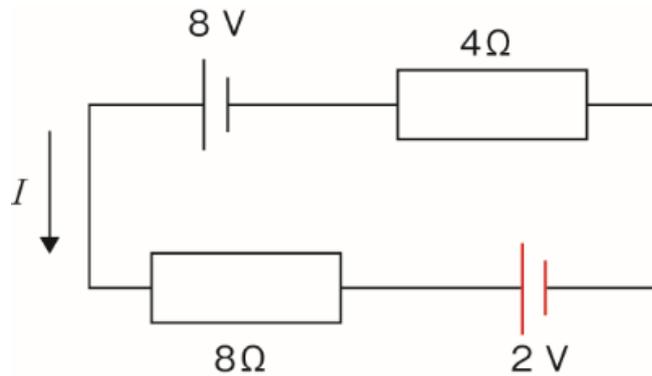

解説

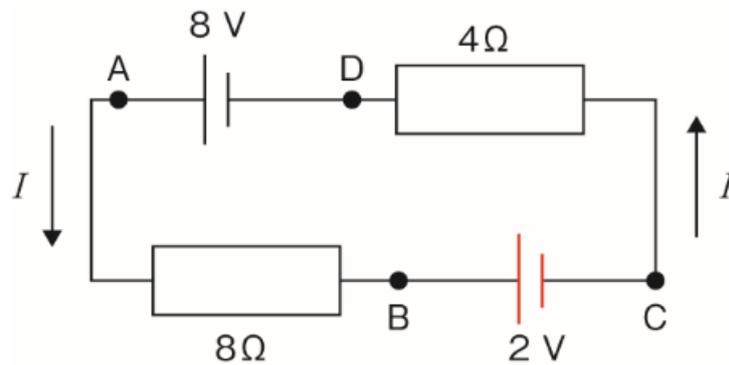

2024年8月2日

Gakken メディカル出版事業部